


平成29年度 愛知県臨床検査精度管理調査 報告会

精度管理調査概要 アンケート集計報告

精度管理事務局 安城更生病院


杉山 大輔

精度管理事業の取り組み

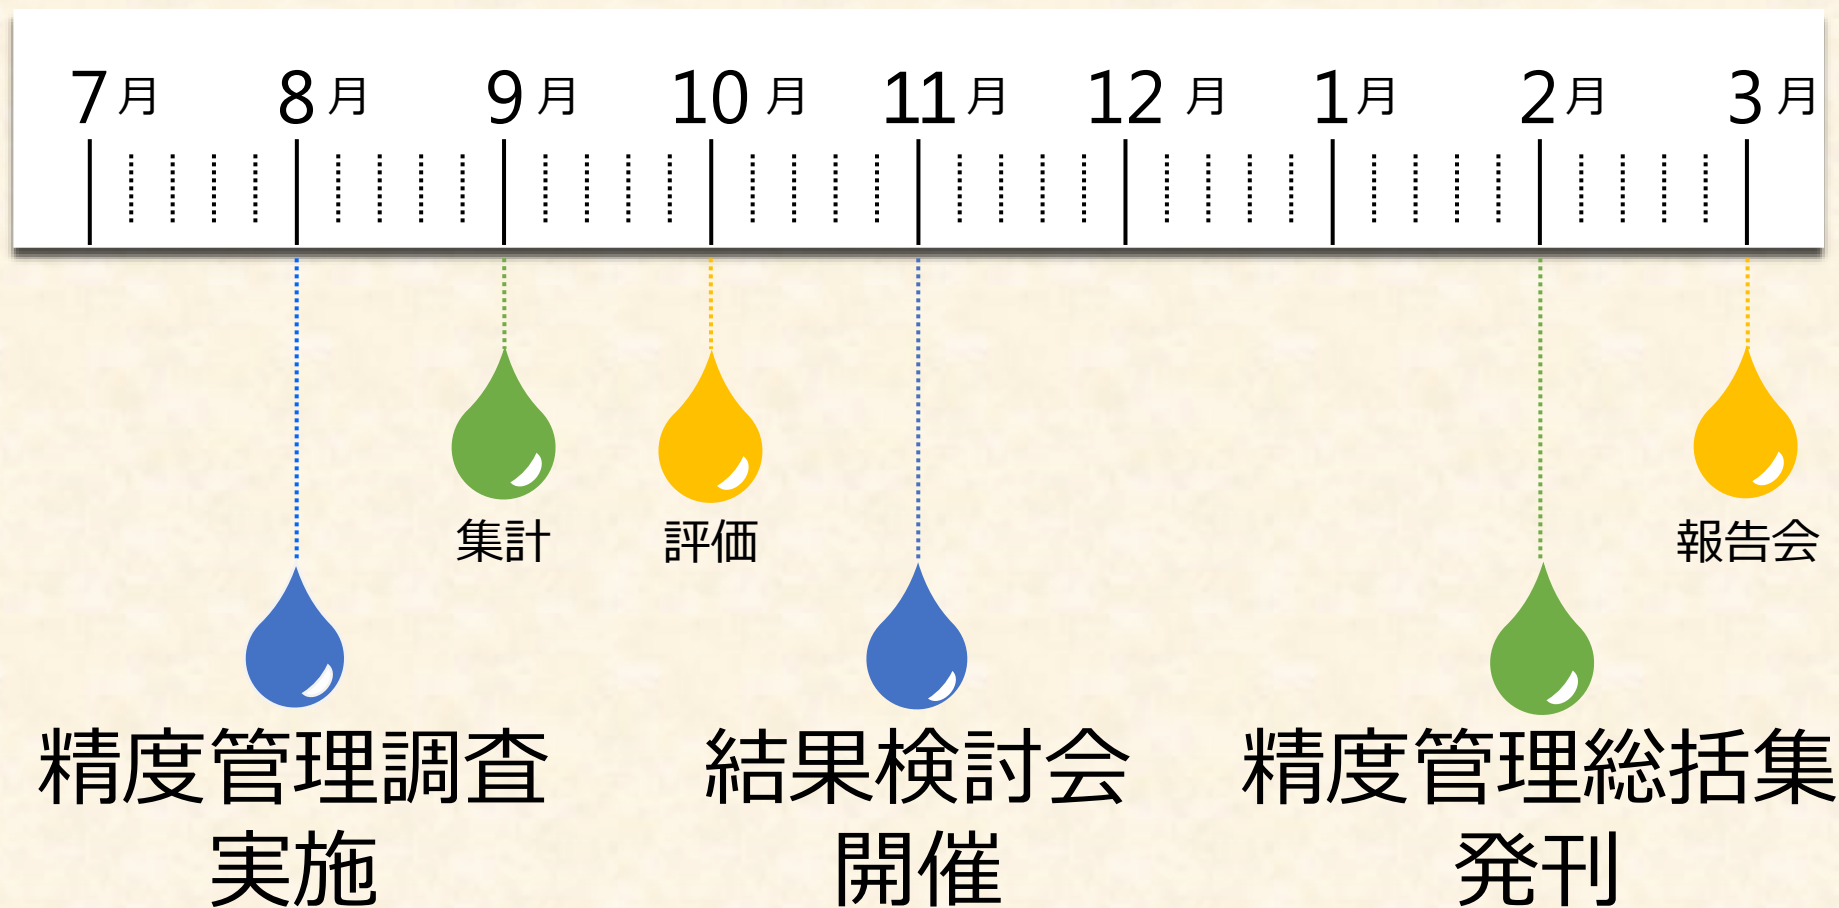

精度管理調査・実施内容

フォトサーベイ

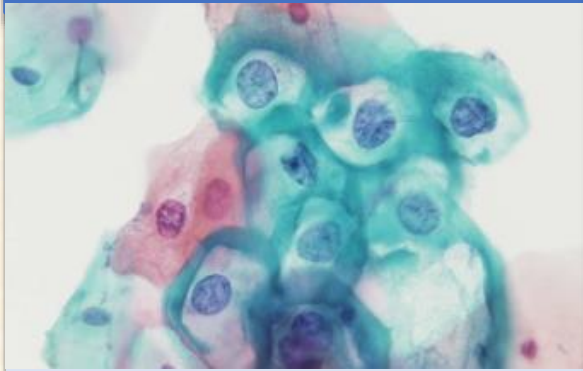


血液検査
一般検査
生理検査
微生物検査
細胞検査
病理検査

サンプルサーベイ



臨床化学検査
免疫血清検査
血液検査
一般検査
輸血検査
微生物検査


染色サーベイ

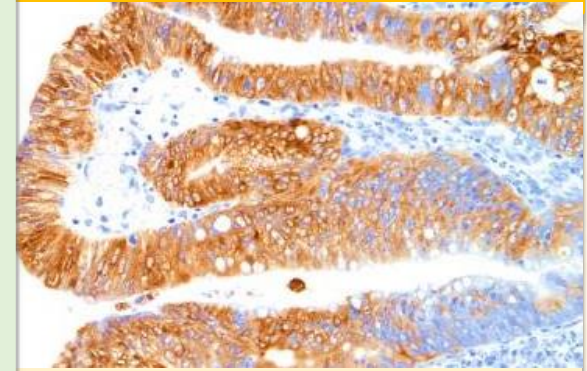

病理検査
(※評価対象外)

平成29年度参加状況

参加施設

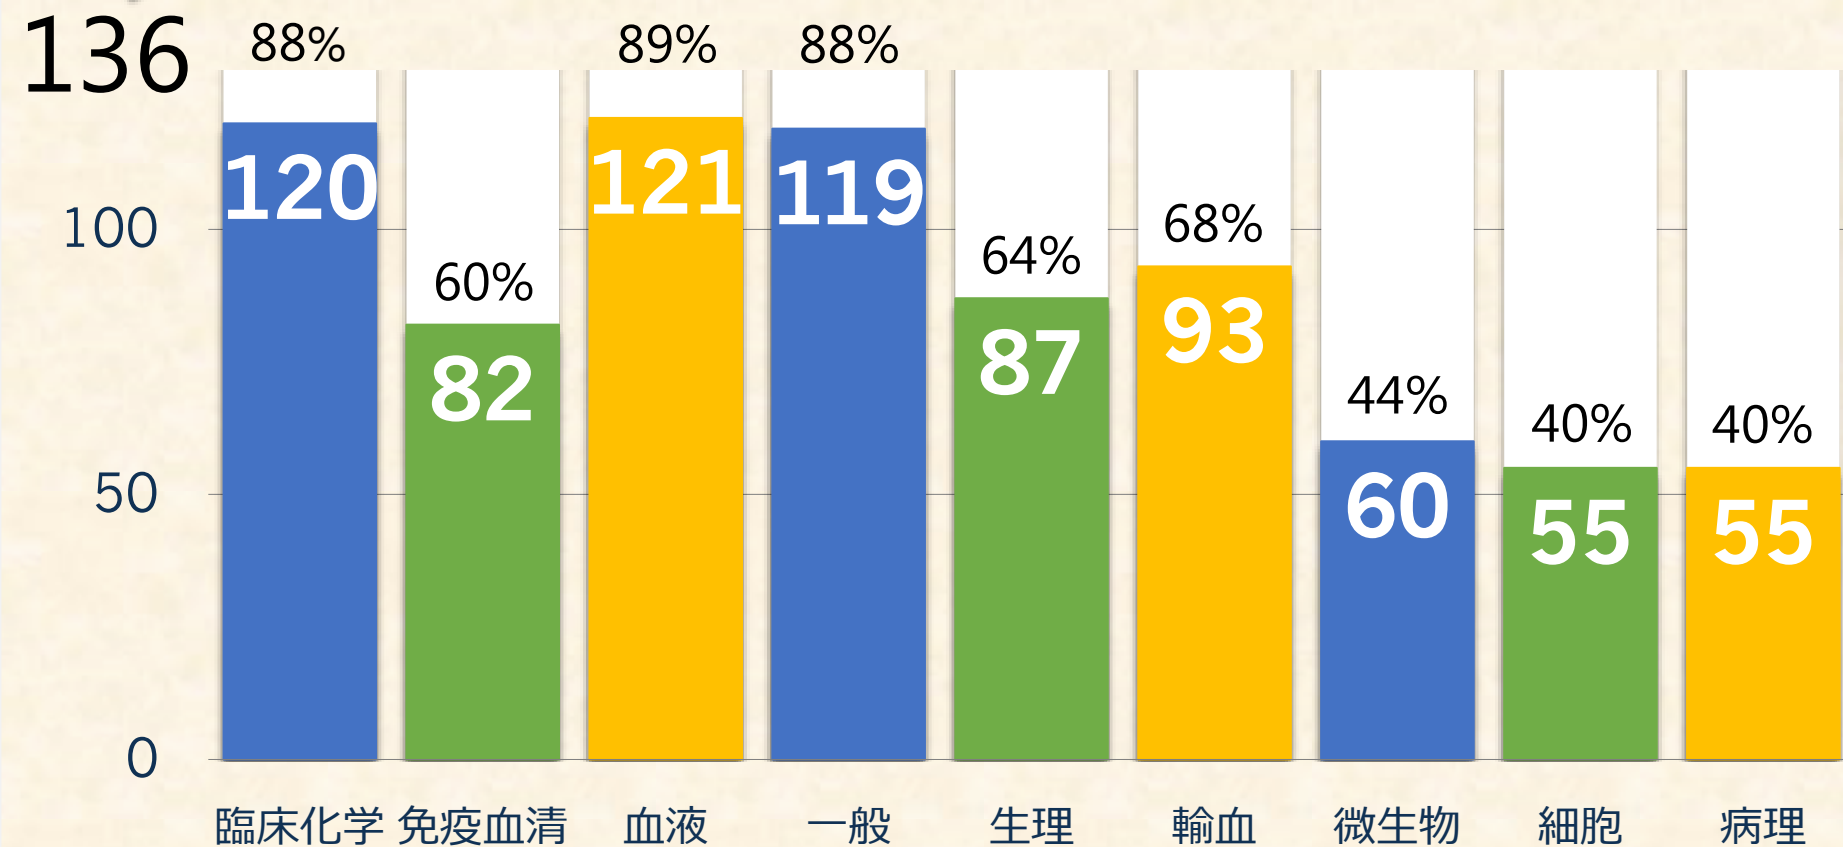

アンケート調査概要

・対象

平成29年度愛知県臨床検査精度管理調査に参加した136施設

・調査内容


・技師長クラスの方

参加費の妥当性、日臨技精度保証施設認定制度、総括統計表、事業全般に対する意見や要望など


・各部門

試料の量、設問量、設問の難易度、JAMTQCについてなど

参加費の妥当性

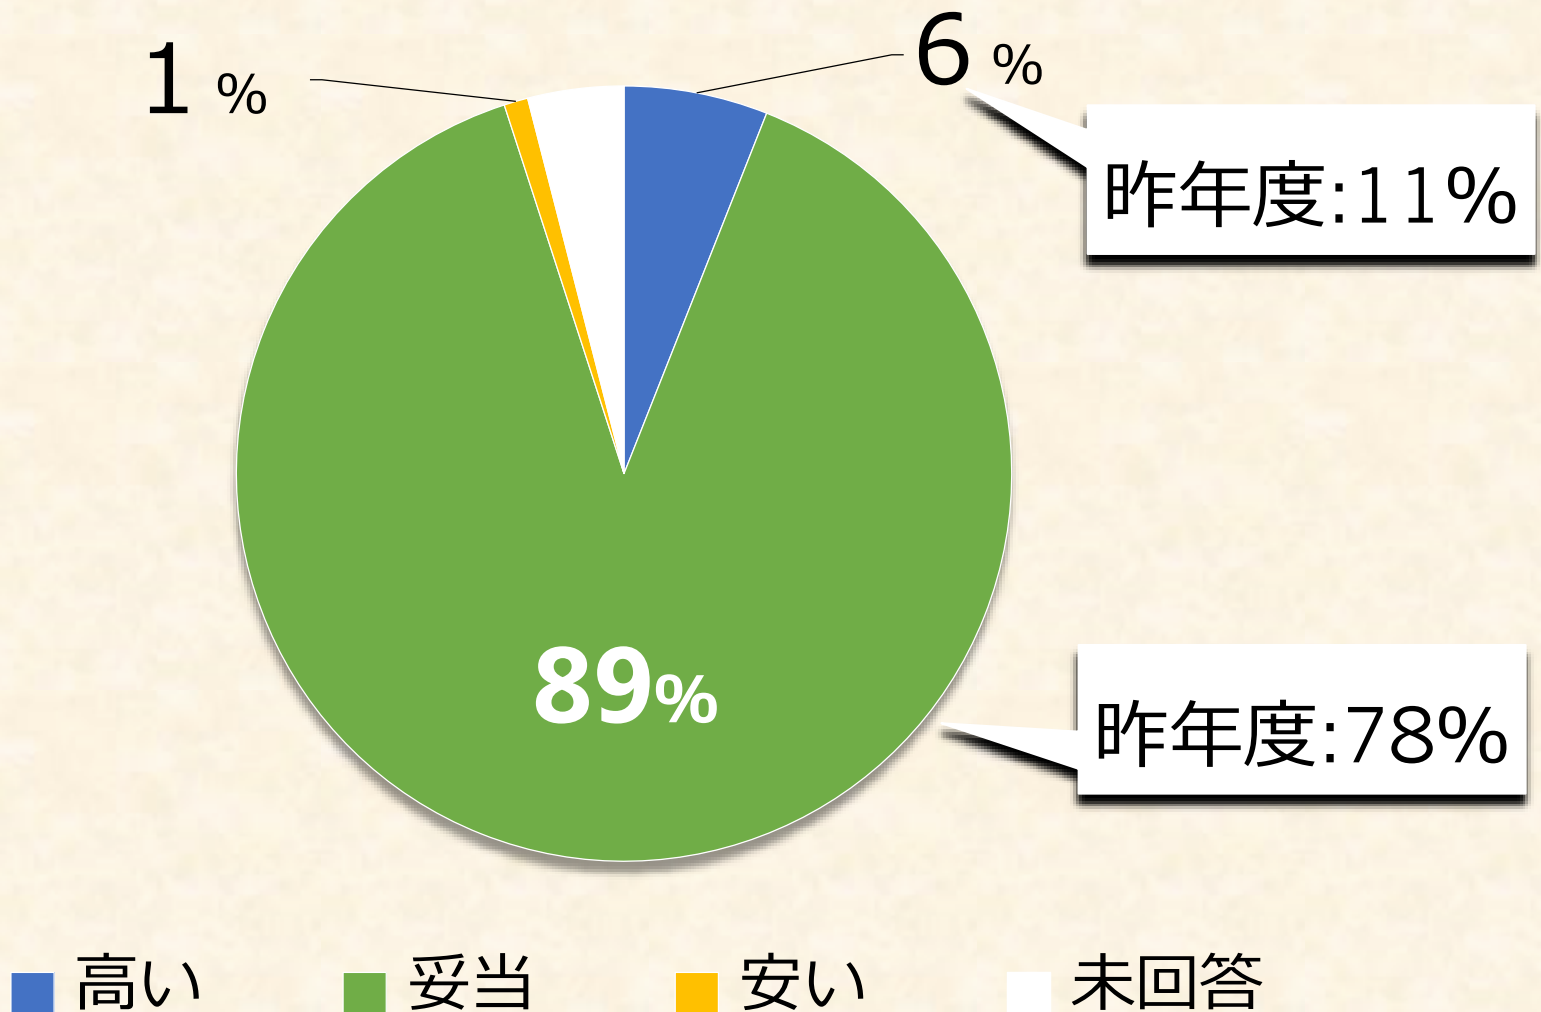

日臨技精度保証施設認定制度

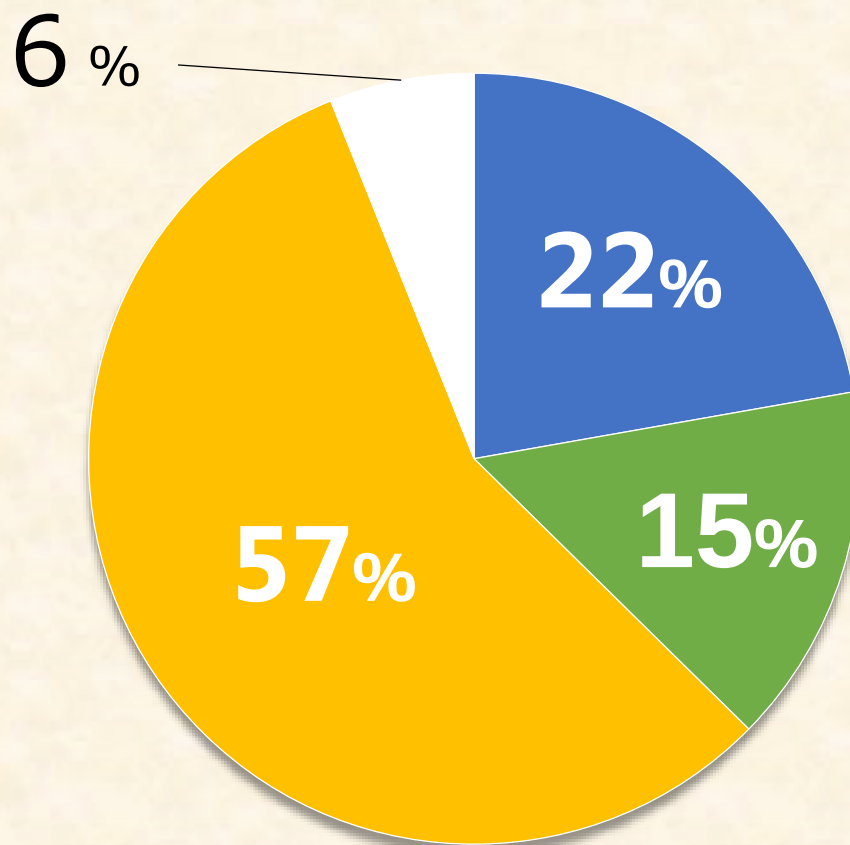


■ 認定受審済

■ 受審予定

■ 受審予定なし

■ 認定制度を知らない/未回答

総括統計表

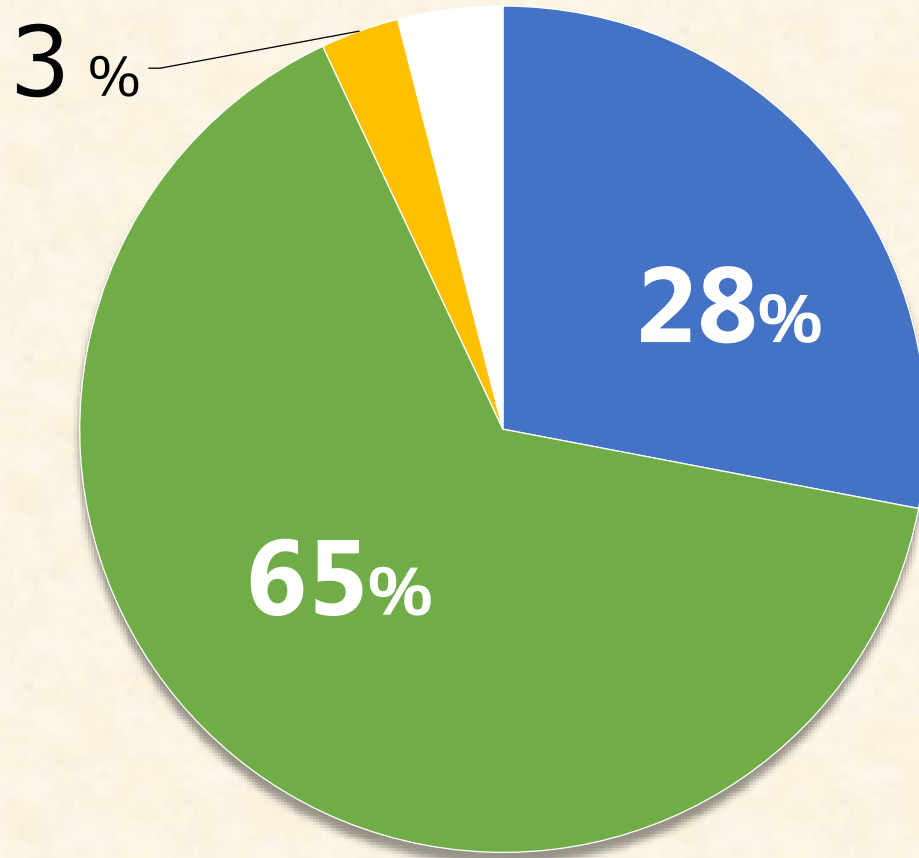

■ 公開メール後直ちに閲覧

■ 閲覧したことがない


■ 閲覧している

■ 未回答


精度管理事業に関する意見

- ・ 実施時期が医師会関係とほぼ同時期であることや項目が重複していることなど、申し込み、料金振り込みなどで混乱しがちになる
- ・ 一部の設問で回答を入力しても『回答中』のままで困惑した
- ・ 毎年しっかりやっていただいてありがたい


サンプルサーベイ 試料量

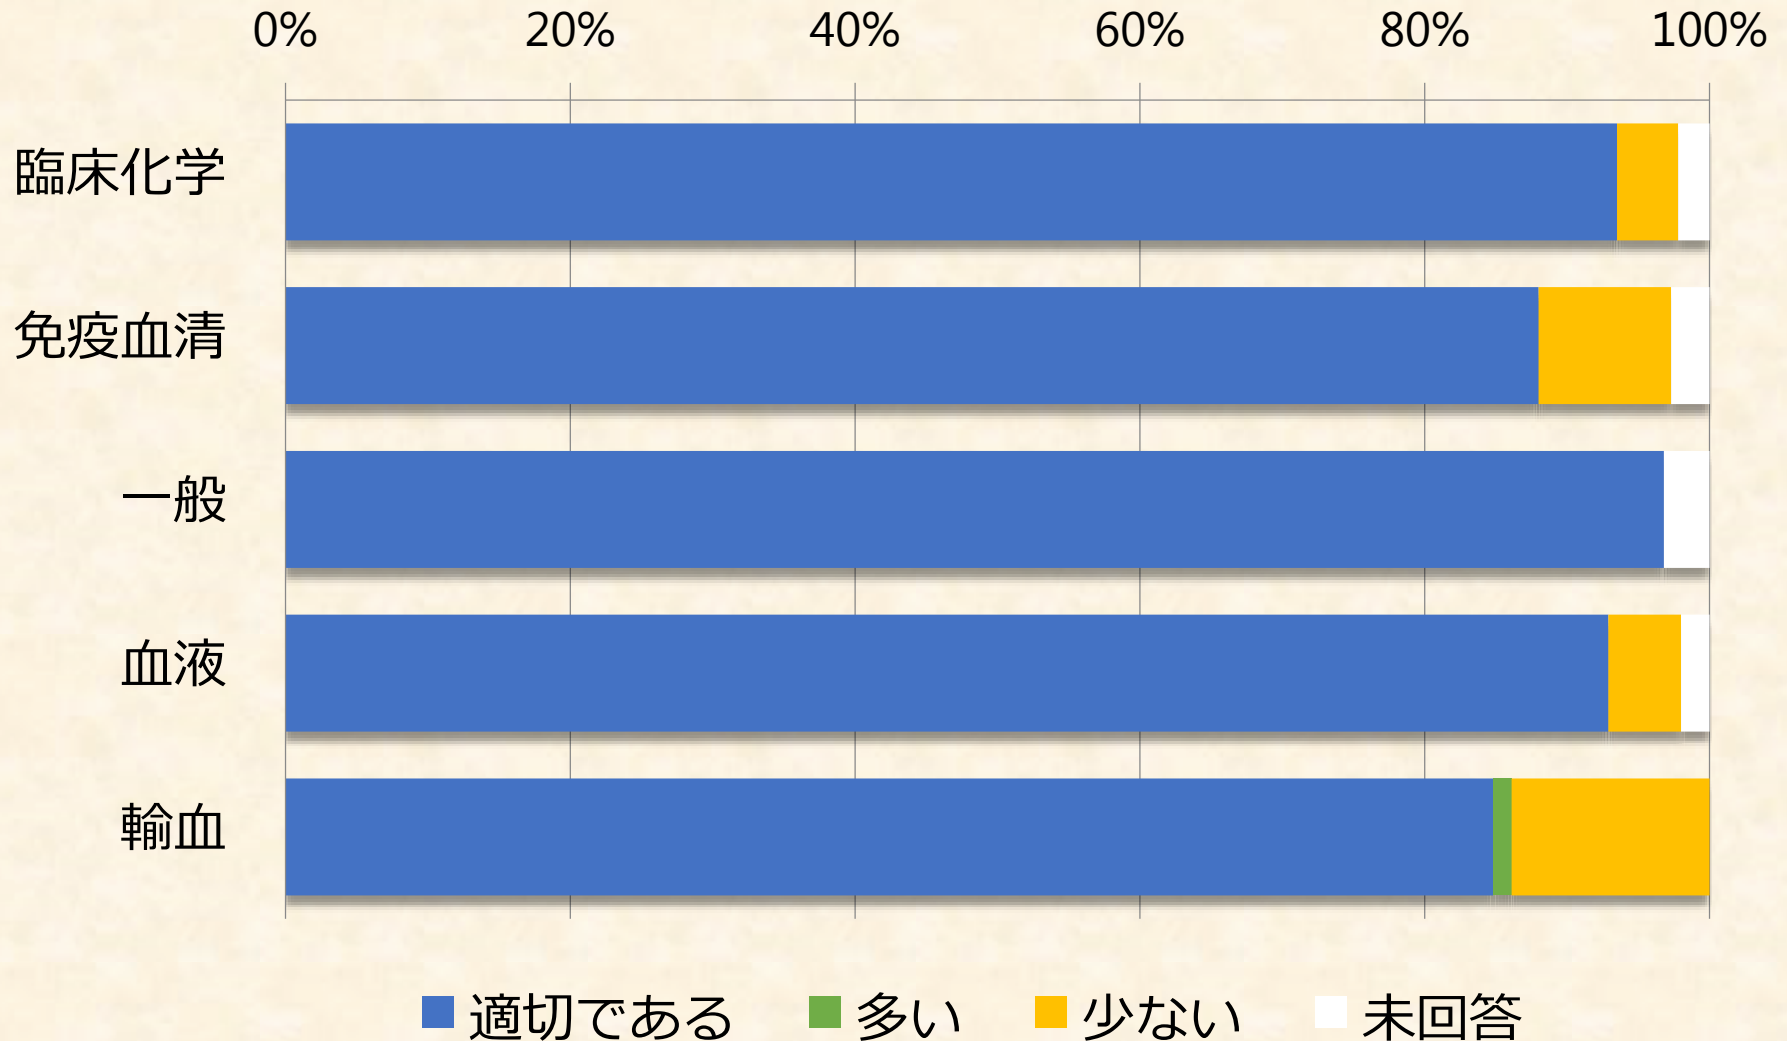


臨床化学部門 試料量

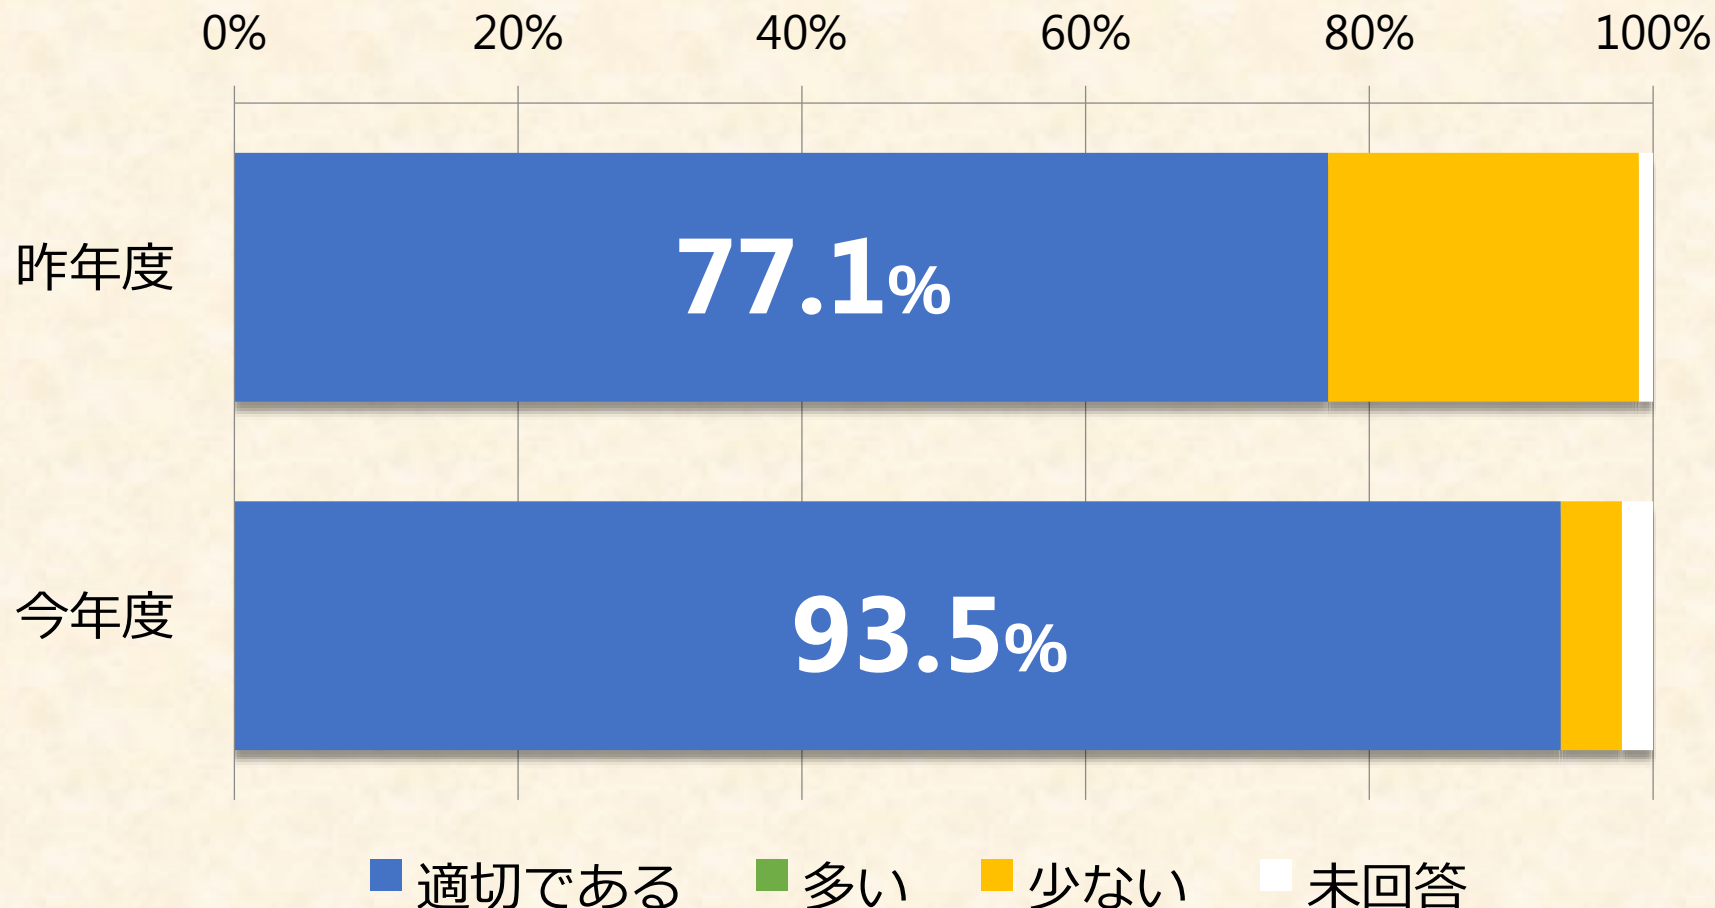


フォトサーベイ 設問量

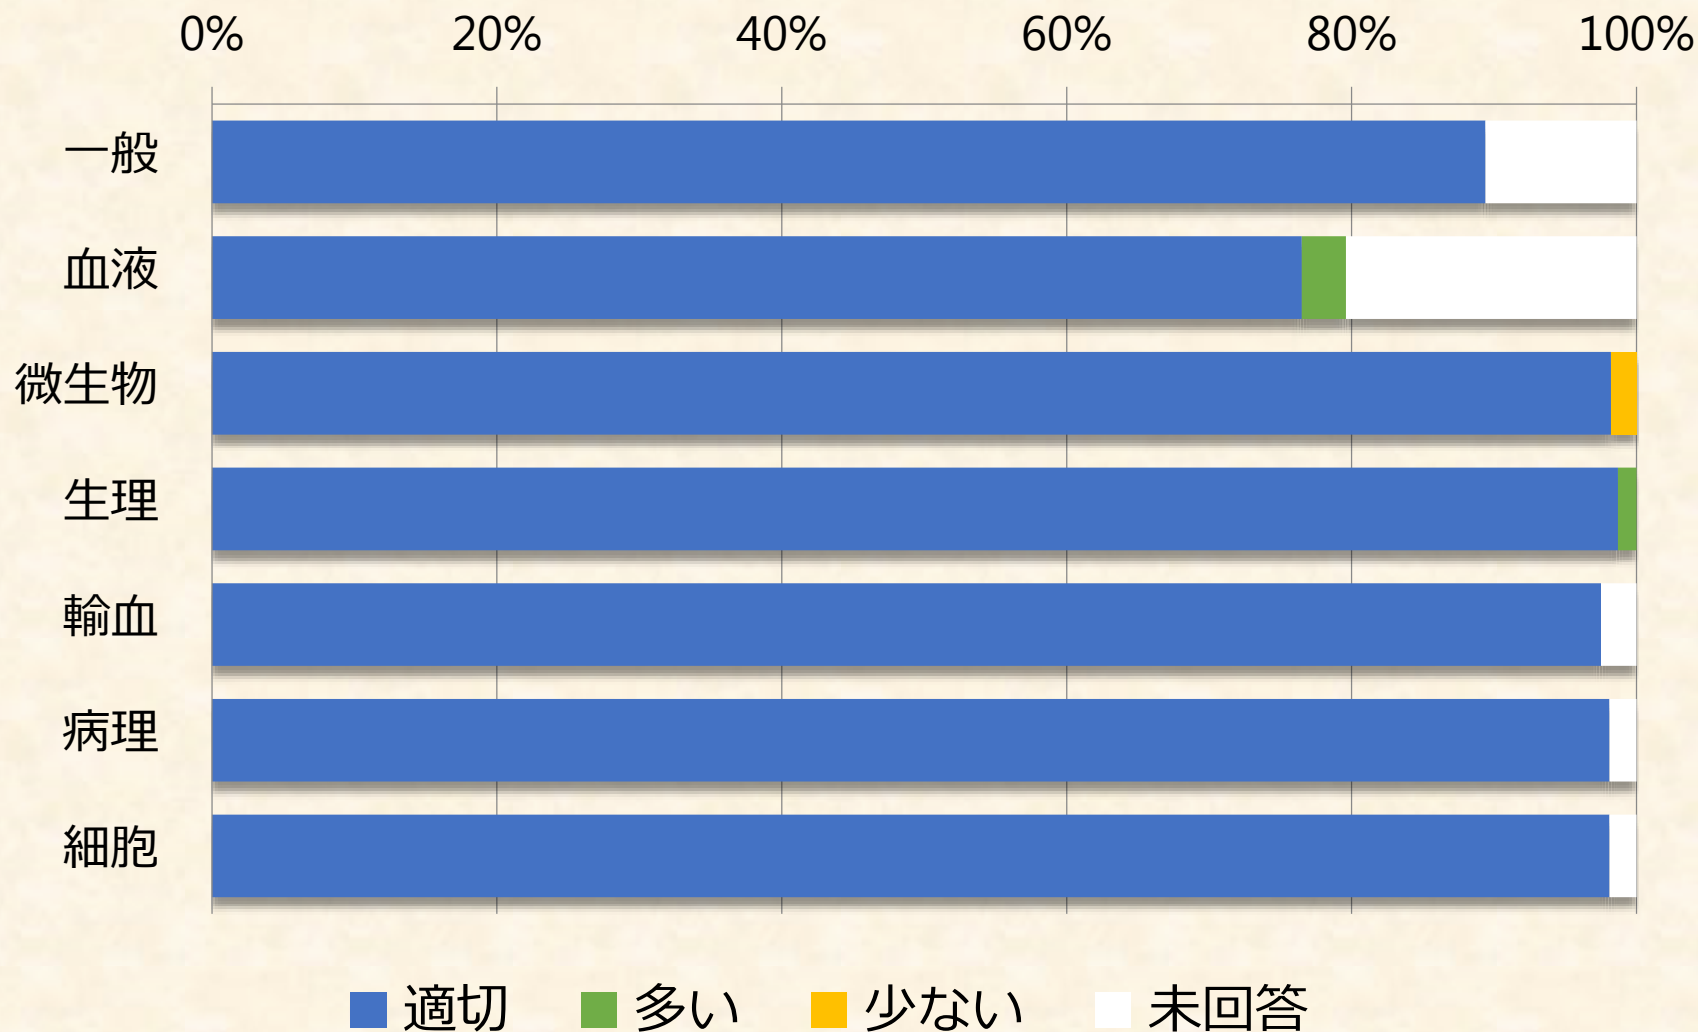


フォトサーベイ 難易度

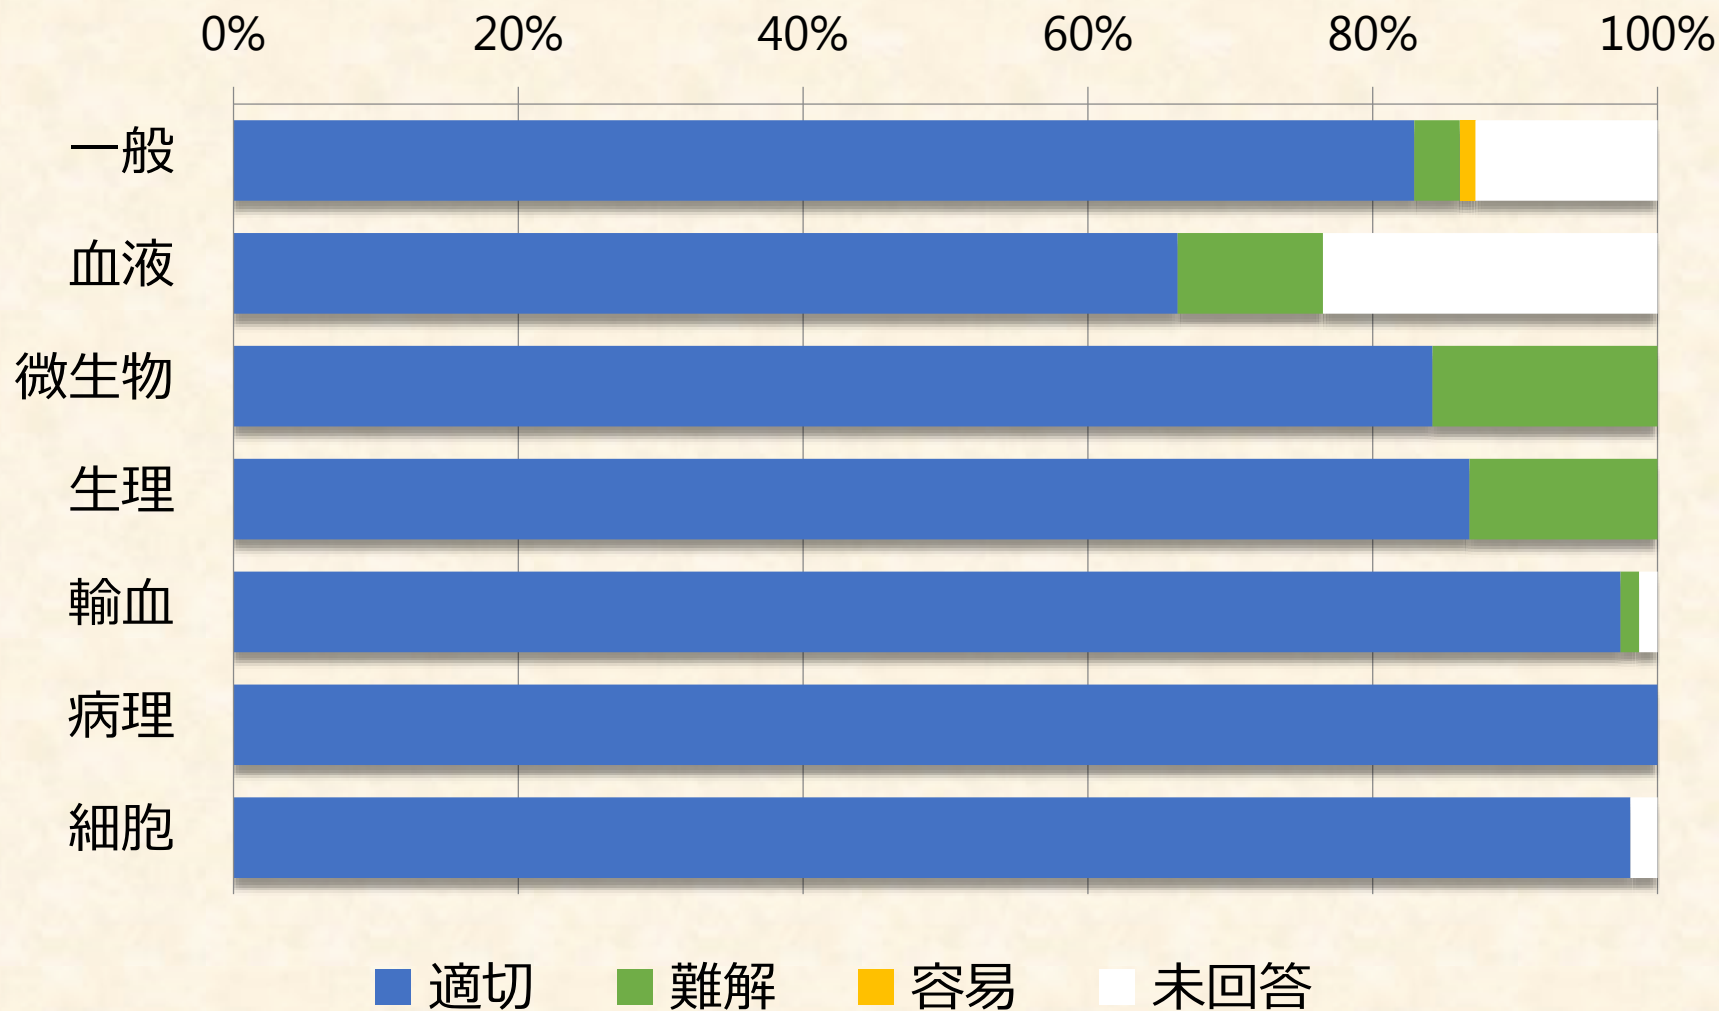

細胞部門 難易度

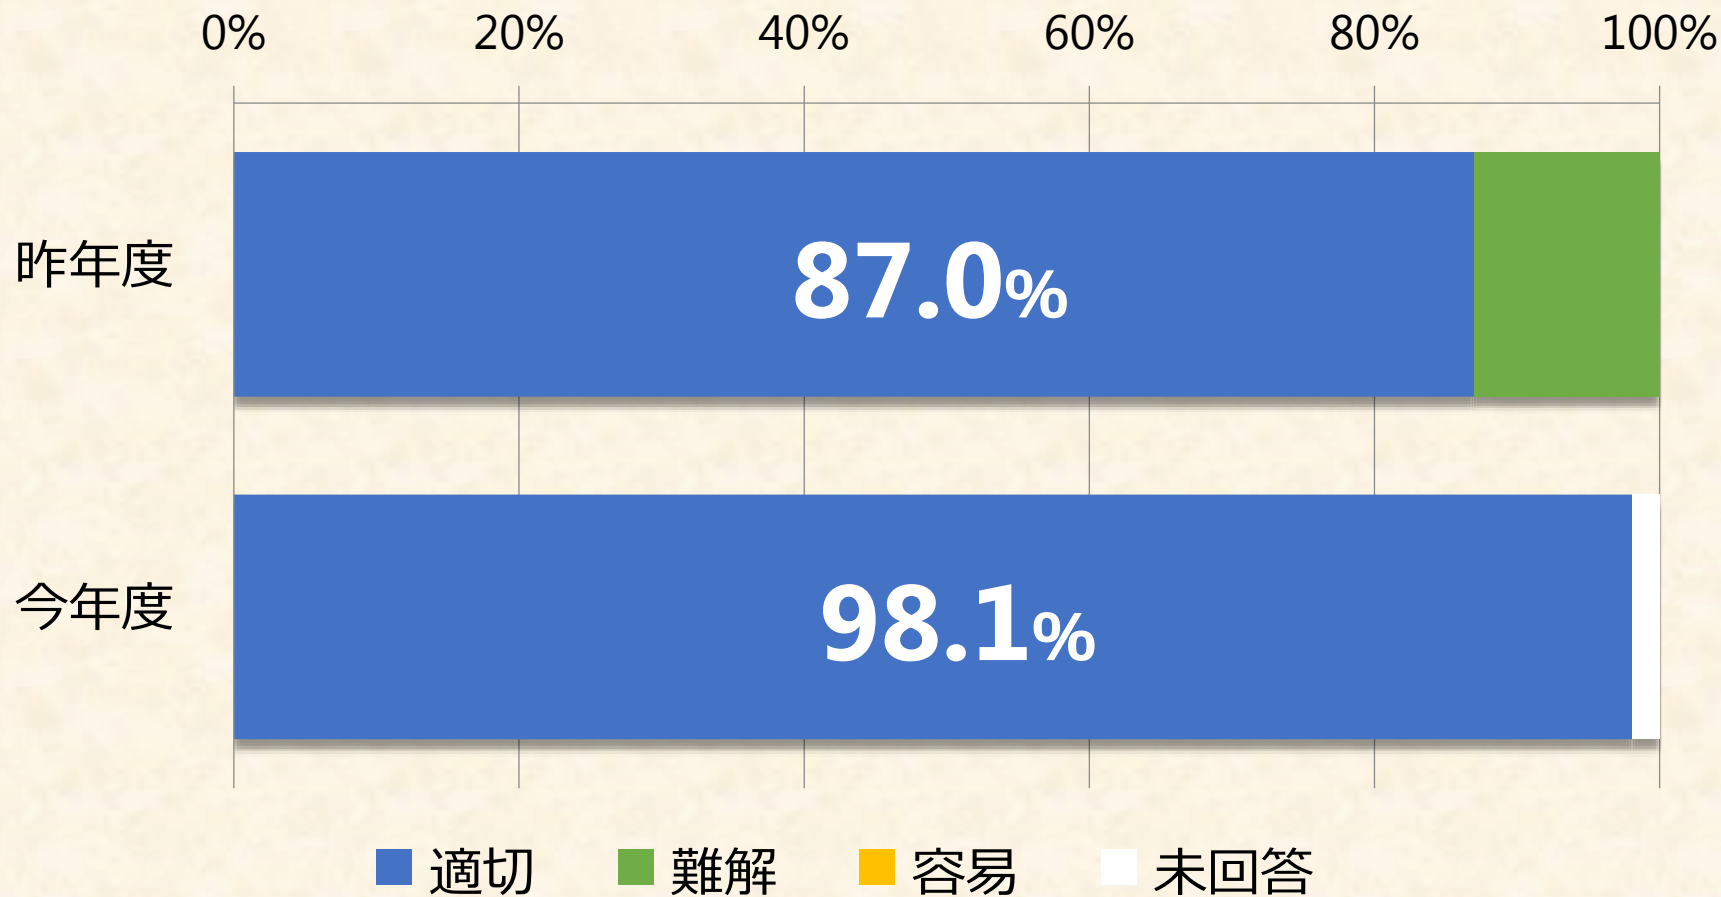

JAMTQCシステムについて

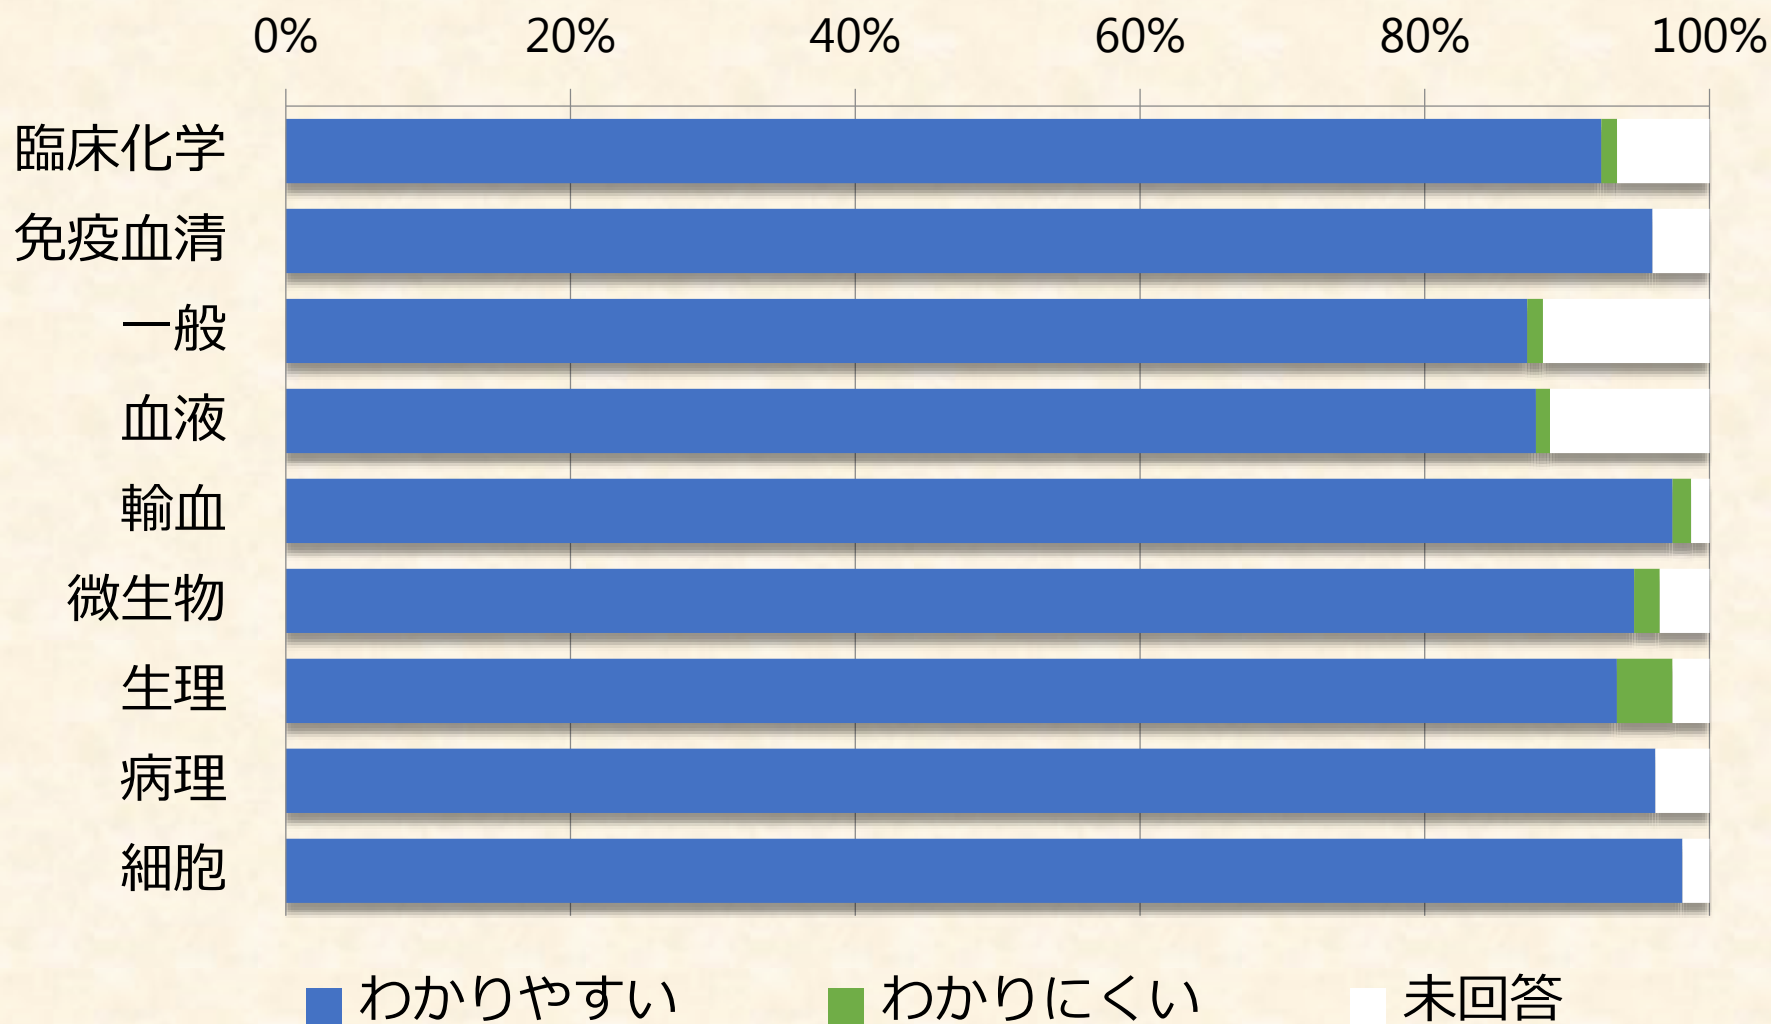

まとめ

- 1 精度管理調査運用に概ね支障はない
- 2 試料量や難易度に部門間差がみられたが昨年度と比較して改善が認められた
- 3 限られた予算の中でより充実した精度管理調査を実施できるよう善処する

今後の課題

1

結果検討会の開催場所、開催回数

2

小規模施設へのサポート体制の構築

3

日臨技精度管理調査のサポート事業展開

最後に・・・

☆ 精度管理事務局からのお願い ☆

- ・ 正しいメールアドレスの入力
- ・ 参加費の入金（未納施設）

来年度以降も精度管理事業へのご理解、
ご協力をよろしくお願い致します