

令和4年度 愛知県臨床検査精度管理調査報告 事務局総括

愛知県臨床検査技師会 精度管理事務局
大島 康裕
(愛知県がんセンター)

令和4年度精度管理事業の取り組み

◎令和4年度は感染症拡大防止に留意しつつ、例年通りの調査内容を実施した

◎標準作業手順書や精度管理責任者に関する運用方法についてアンケートを実施した

◎結果検討会と精度管理調査報告会を集合形式にて開催した


◎遺伝子・染色体検査、生殖医学検査を昨年度に引き続き実施した

令和3年度精度管理調査スケジュール

日程		内容
令和4年	6月	募集要項発送・申し込み開始
	7月13日	申し込み締め切り
	8月21日	試料発送
	8月22日	試料到着
	9月2日	回答締め切り
	10月	施設別報告書掲載
	11月6日	結果検討会
令和5年	3月	総括集発刊・掲載
		精度管理調査報告会


参加施設統計

令和4年度参加施設数: 157施設 (前年度+16施設)

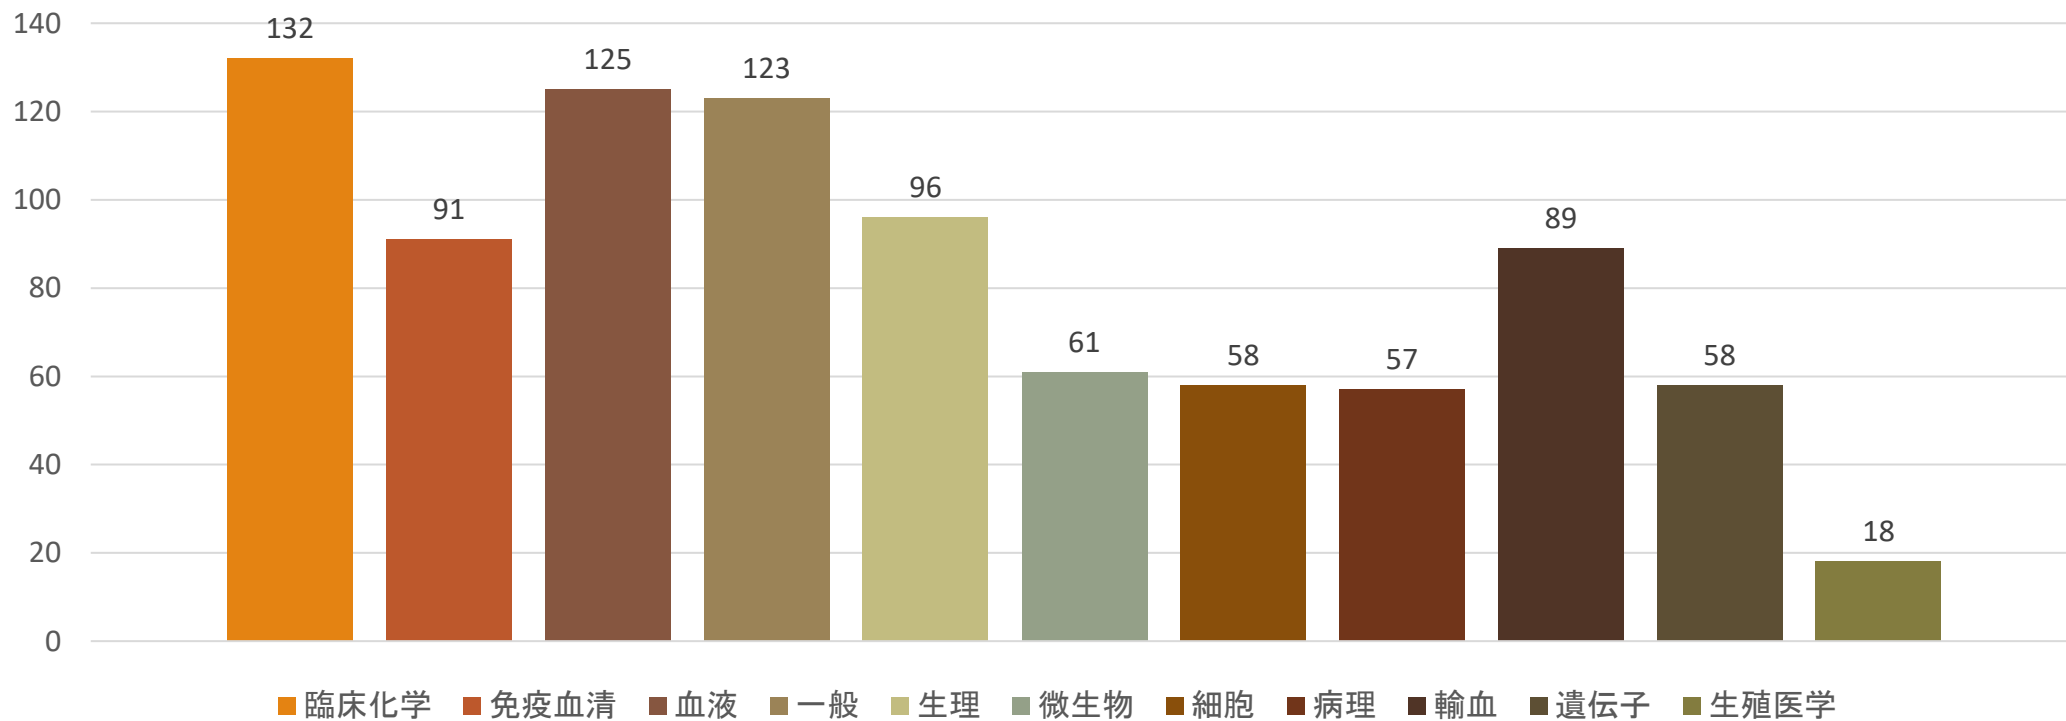

参加施設統計

令和4年度参加施設数: 157施設 (前年度+16施設)

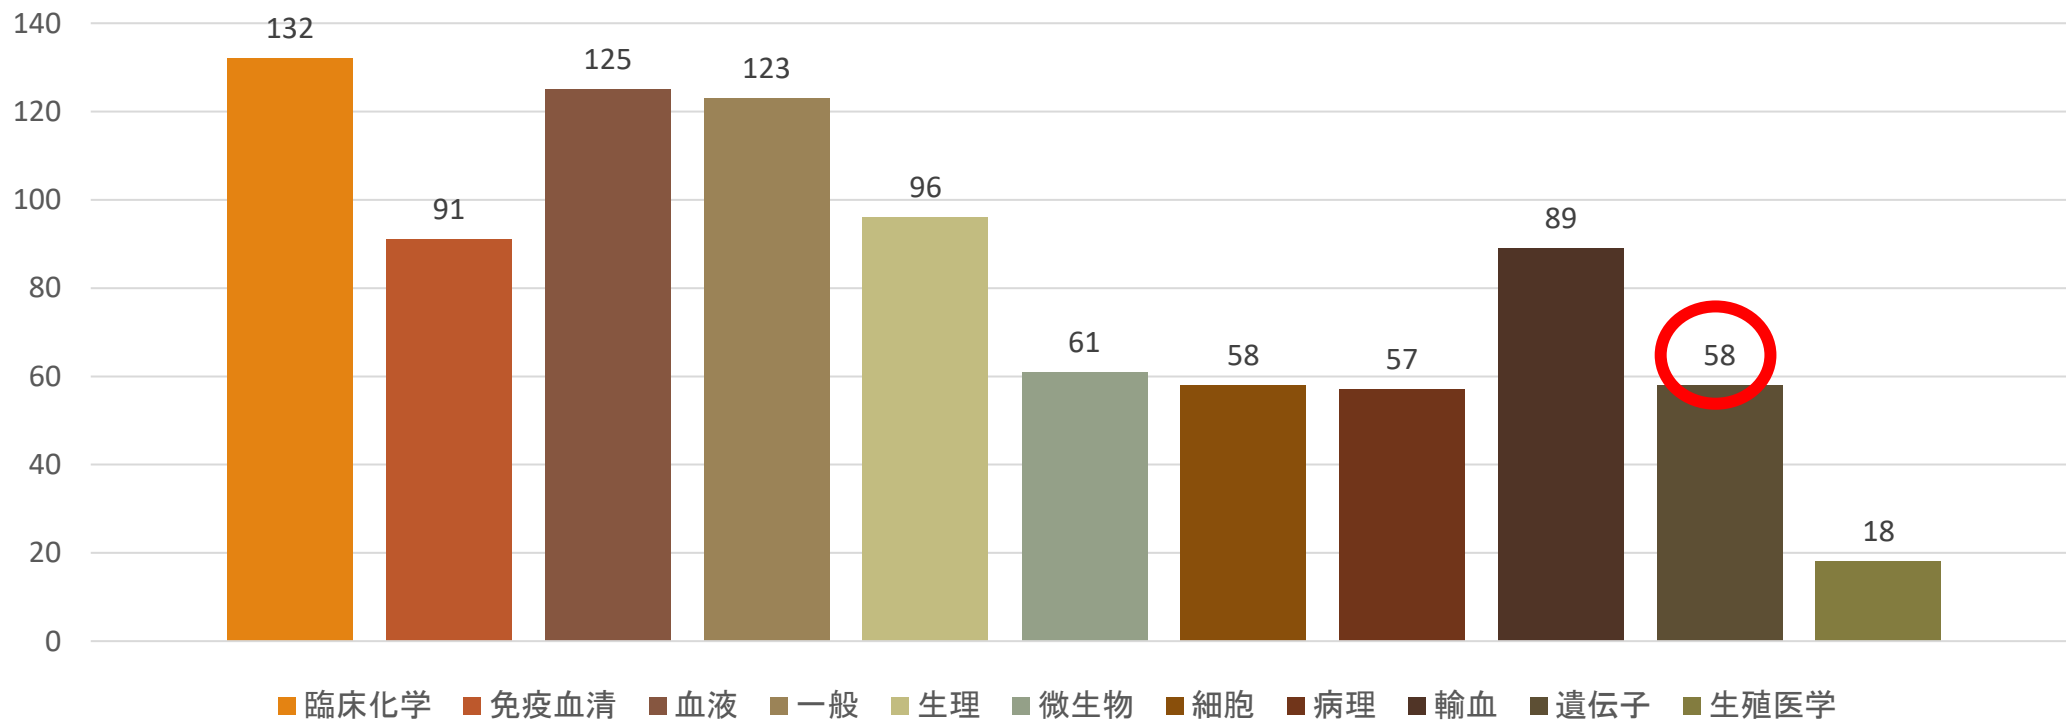

アンケート調査内容

- 参加費の妥当性
- 結果検討会の必要性と開催形式について
- 精度管理調査報告会の開催形式について

- SARS-Cov-2核酸増幅検査の精度管理調査について
- 精度管理責任者を決めているか
- 標準作業手順書について
- 標準作業手順書の作成進捗状況について


アンケート調査内容

- 参加費の妥当性
- 結果検討会の必要性と開催形式について
- 精度管理調査報告会の開催形式について


- SARS-Cov-2核酸増幅検査の精度管理調査について
- 精度管理責任者を決めているか
- 標準作業手順書について
- 標準作業手順書のせ作成進捗状況について

アンケート調査内容①

参加費の妥当性

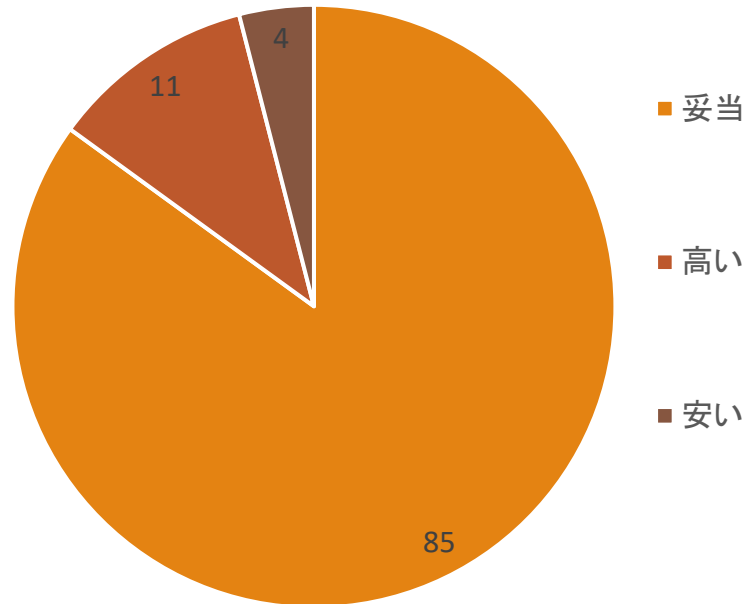


参加費の妥当性(昨年度)

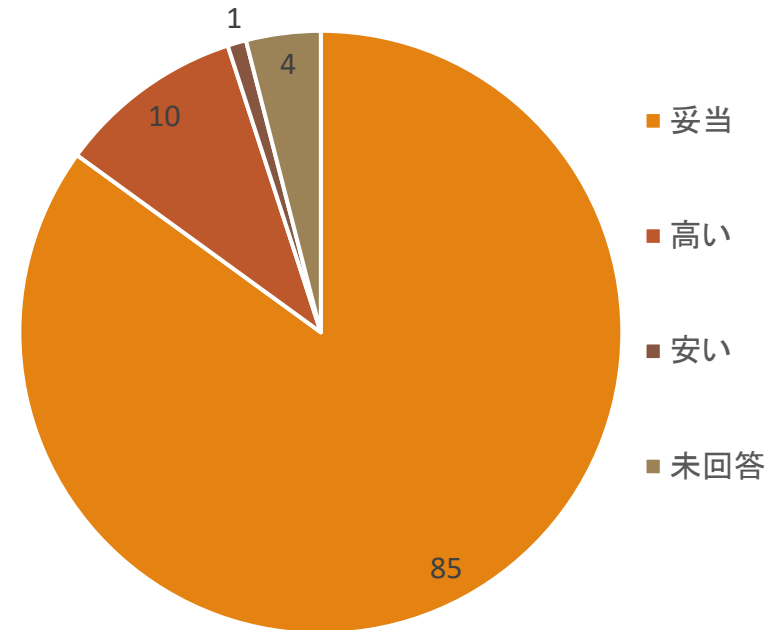


アンケート調査内容①

結果検討会の必要性について

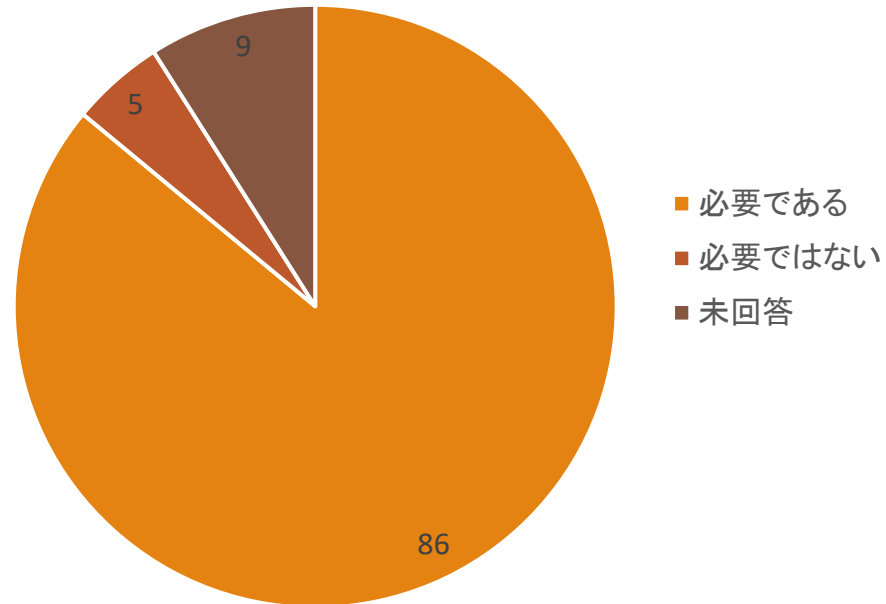


結果検討会の必要性について(昨年度)

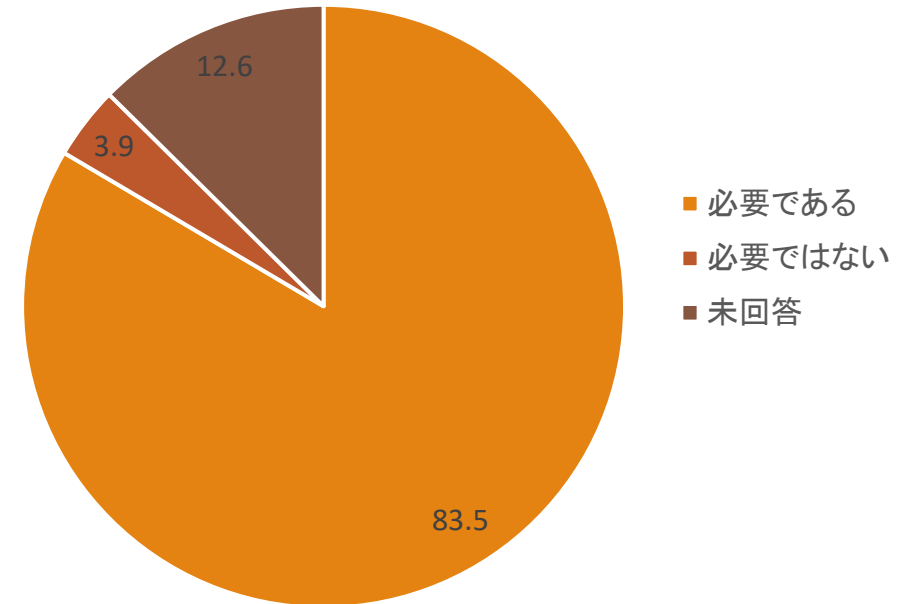


アンケート調査内容①

結果検討会の開催形式について

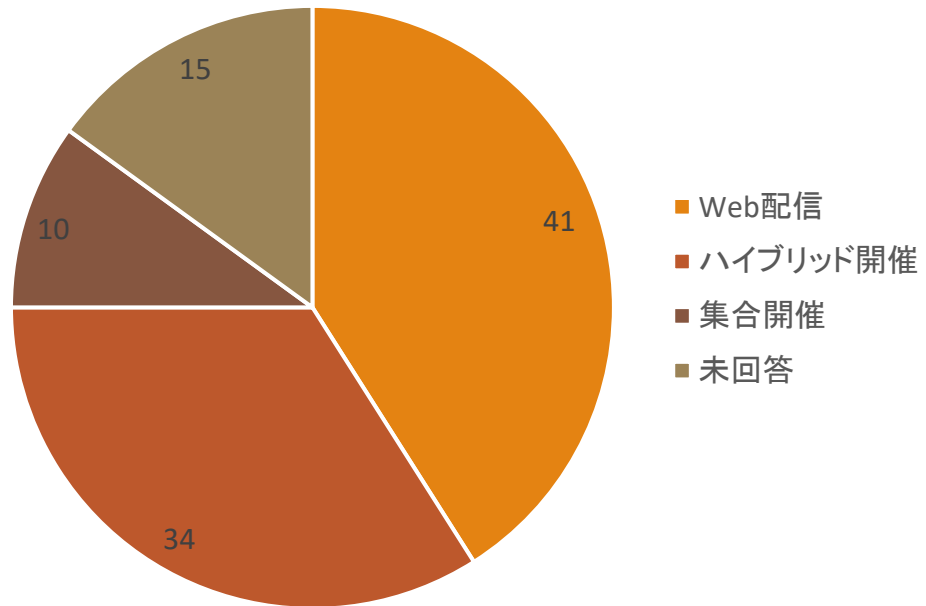


結果検討会の開催形式について(昨年度)

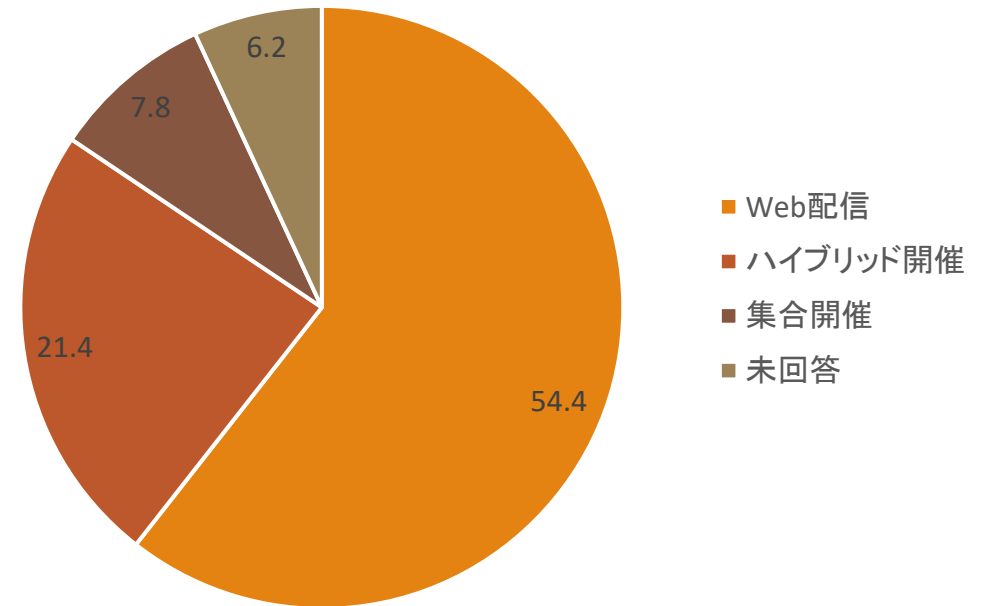


アンケート調査内容①

報告会の開催形式について

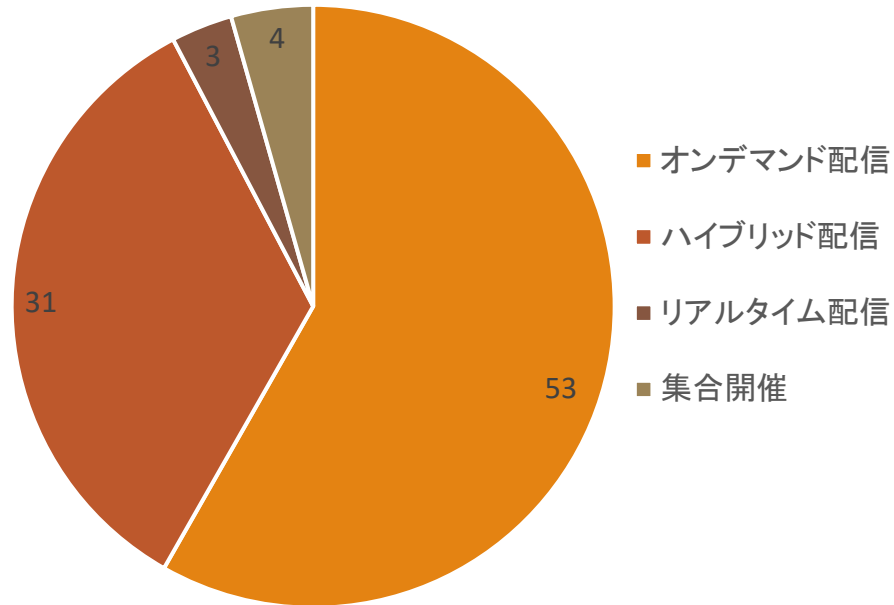

報告会の開催形式について(昨年度)

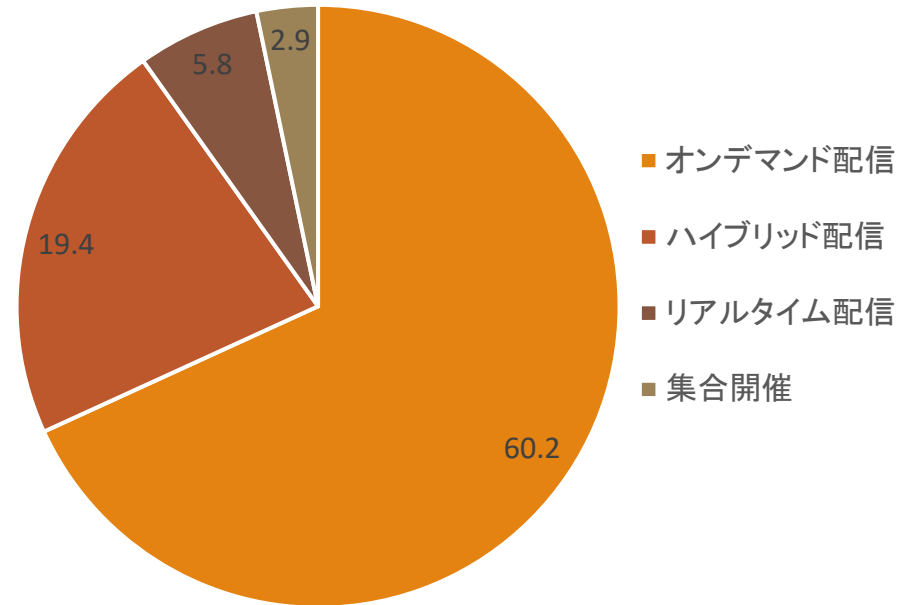


アンケート調査内容

- 参加費の妥当性
- 結果検討会の必要性と開催形式について
- 精度管理調査報告会の開催形式について

- SARS-Cov-2核酸増幅検査の精度管理調査について
- 精度管理責任者を決めているか
- 標準作業手順書について
- 標準作業手順書の作成進捗状況について


アンケート調査内容①

SARS-CoV-2核酸増幅検査の精度管理調査について

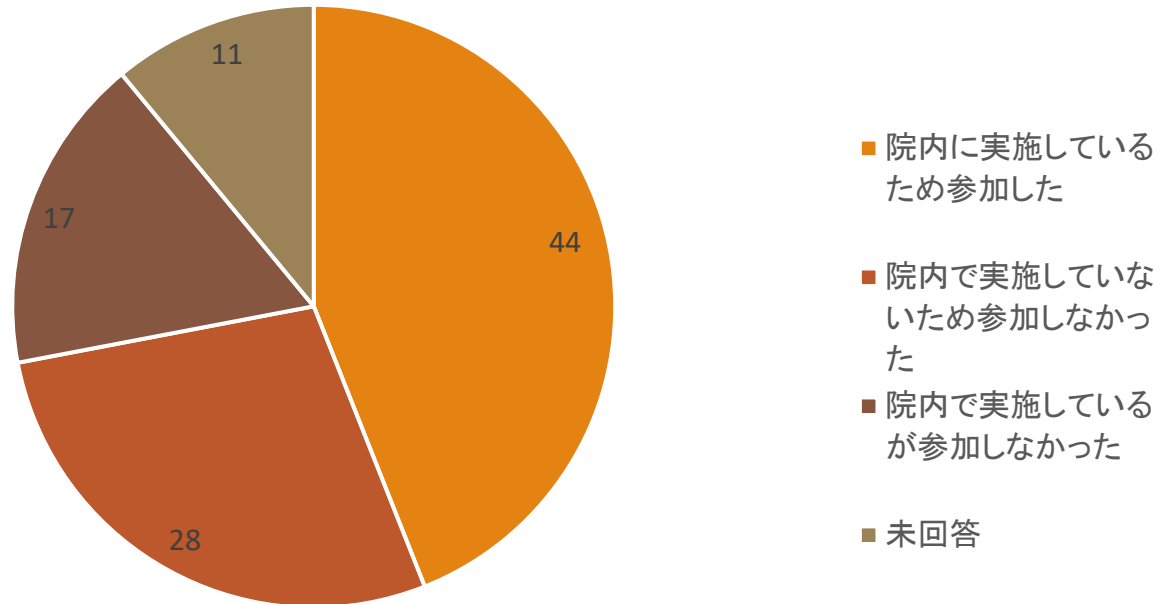


アンケート調査内容①

「精度管理責任者」を決めているか

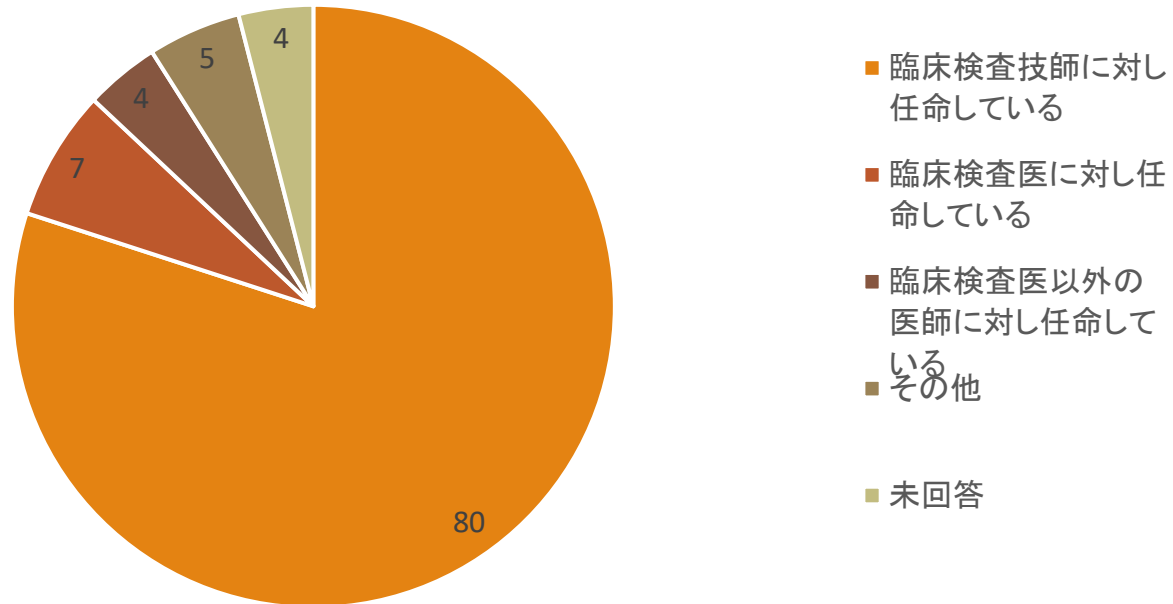


アンケート調査内容①

標準作業手順書について

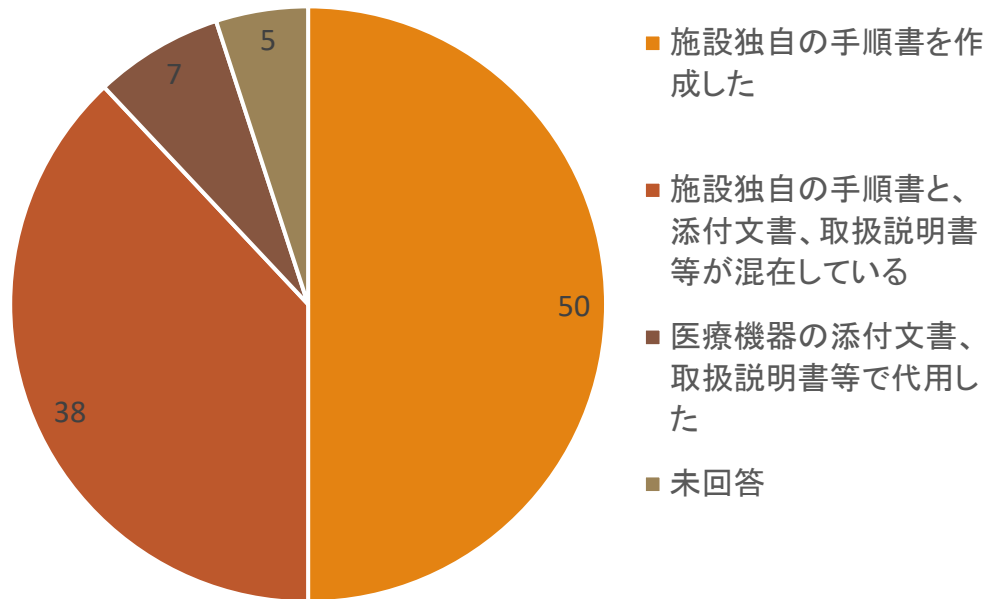

標準作業手順書等の作成進捗状況

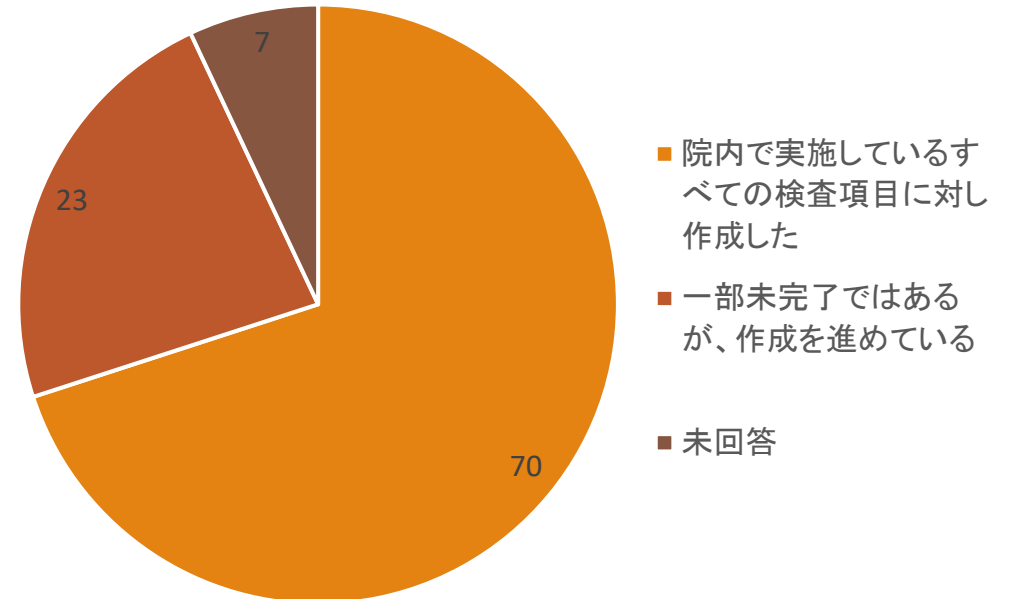

総括

- ・今年度のアンケート調査では、例年同様の内容とともに、結果検討会や精度管理調査報告会の意見、要望を再調査した。
- ・結果検討会、精度管理調査報告会ともに、70%以上の施設がweb形式あるいはハイブリッドでの開催を希望していた。
- ・昨年度と比較して、集合開催を希望する施設が僅かに増えていた。
- ・精度管理責任者や標準作業手順書の運用、作成進捗に関して各施設の状況を共有できた

愛知県臨床検査技師会 精度管理事業部

部長	齊藤 翠	藤田医科大学病院
事務局長	大島 康裕	愛知県がんセンター
事務局	手嶋 充善	豊橋市民病院
事務局	位田 陽史	公立陶生病院
事務局	及川 彰太	藤田医科大学病院
事務局	桂川 陽平	JA愛知厚生連 安城更生病院

引き続き愛臨技サーベイにご協力賜りますようお願い申し上げます。